





1 Az elemek behelyezése

Használati útmutató 2 IM2-HEM-6181-E-HU-05-04/2022




Használat előtt olvassa el az 1 és 2 Használati útmutatót.

All for Healthcare




2 Dátum és idő beállítása




3 A csuklómandzsetta felhelyezése



4 A megfelelő ülőhelyzet





5 Mérés






## Memóriában tárolt értékek megtekintése

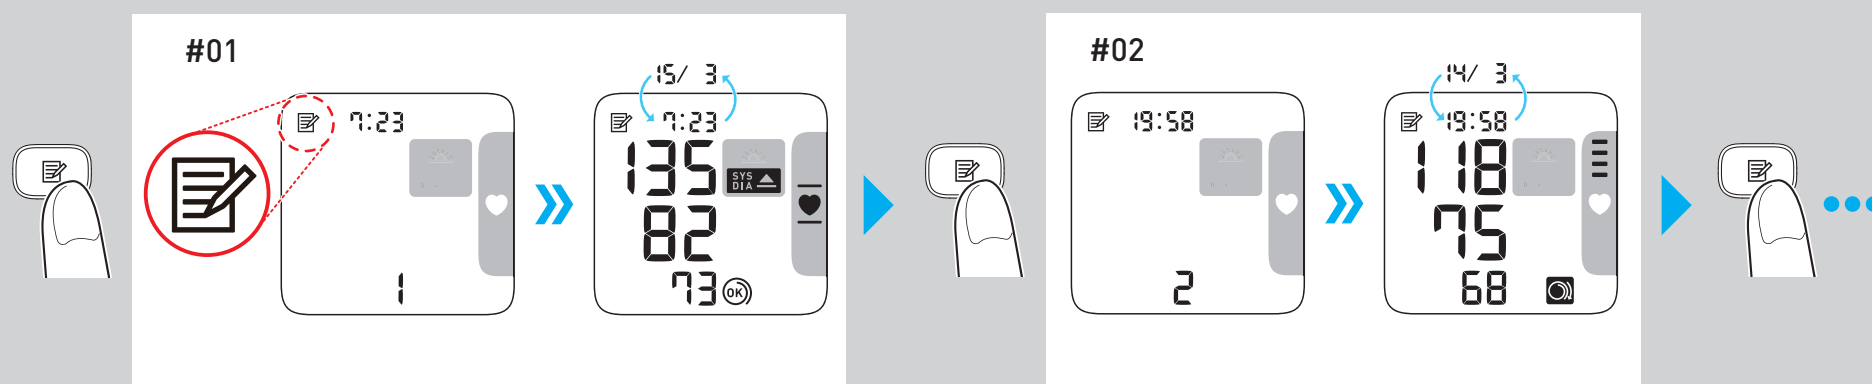

## A memóriában tárolt összes mérési eredmény törlése



## Szimbólumok leírása

	Érintkező rész - BF típus: Az áramütés elleni védelem szintje (áramszivárgás)		Hőmérsékletre vonatkozó korlát
	A vérnyomásmérő megfelelő pozícióját jelzi a csuklón. Mérhető csuklókerület 13,5-21,5cm		Páratartalomra vonatkozó korlát
IP XX	Az IEC 60529 által nyújtott IP-védettség foka		Légnyomásra vonatkozó korlát
CE	CE jelölés		A felhasználónak a használati útmutató leírásait kell követnie.
UK CA	UKCA jelölés		A felhasználó biztonsága érdekében a használati útmutató előírásainak pontos betartása szükséges
SN	Sorozatszám		Elem / Akkumulátor
UDI	Egyedi eszközazonosító		Egyenáram
MD	Orvostechnikai eszköz		A gyártás időpontja

Gyártó		<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPÁN
EU-képviselő		<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com
EU importőr		
Termékképviselő		<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Leányvállalatok	Egyesült királysági importőr és UK felelős személy	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors
		<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors
Kiadás dátuma		2022-06-27